

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1992-4163-0191


Udgave: 1

Dato: 1992-12-01

Gyldig til 1994-07-28

Systembetegnelse: IV-293 cs

MÅLEANLÆG

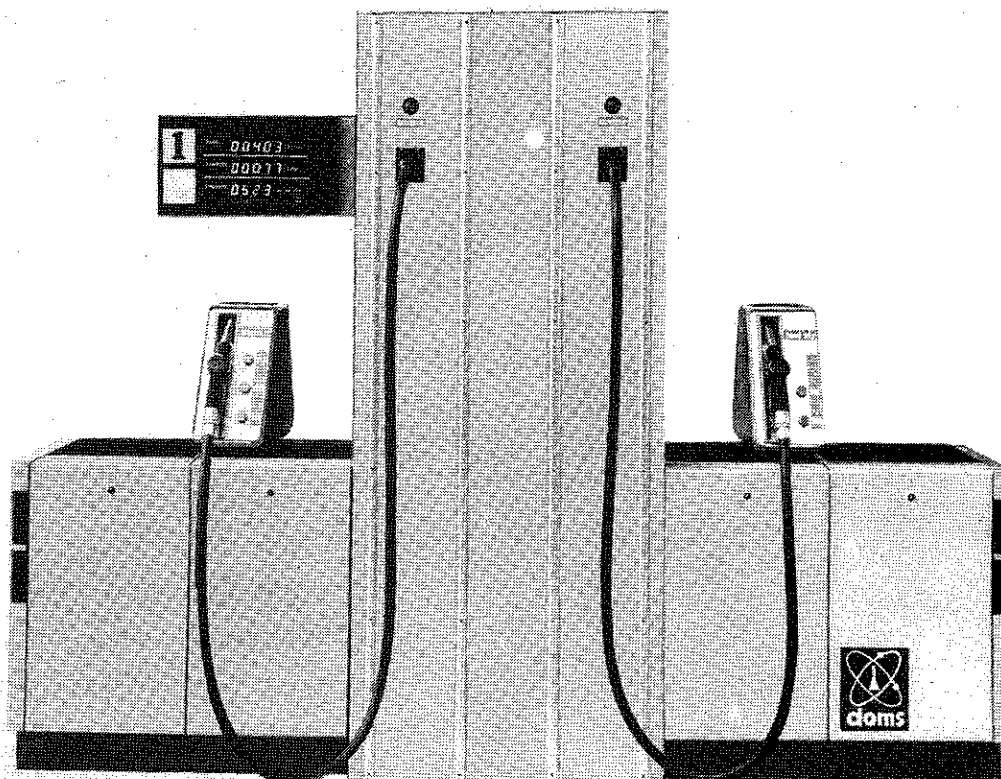

Producent

Gilbarco Ltd., England, Tatsuno, Japan, og
Dansk Olie-Måler Service, Glostrup.

Ansøger

Dansk Olie-Måler Service, Glostrup.


Art

Dobbelt Multi-stander med elektronisk tællerværk.


BEMÆRK !

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

Typer

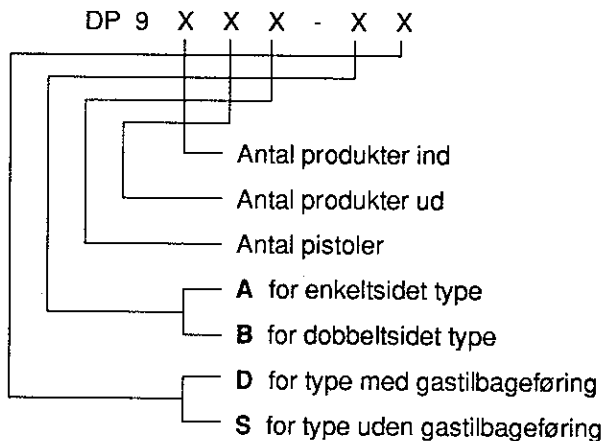

Typerne er opbygget af et grundmodul, type **DP 9000-GM1**,
Sammenbygget med et eller flere pumpemoduler, type:

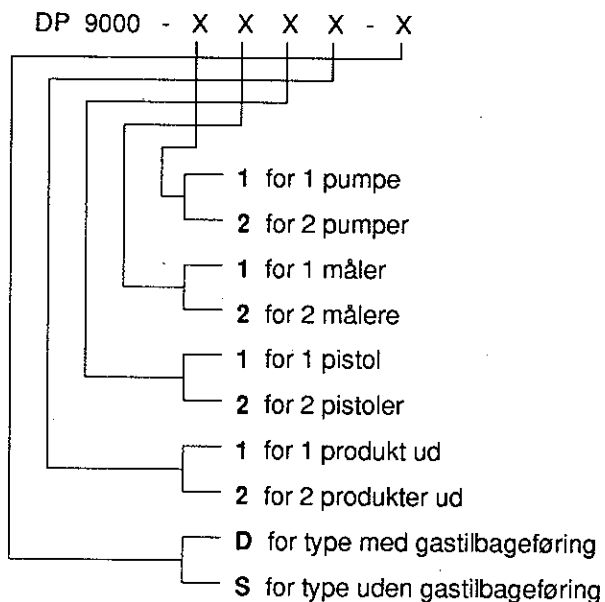

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet		40 liter pr. min.
Mindste verificerede udmåling		5 liter
Tællværk:		
Pristæller	, kapacitet	999.99 kr.
	, deling	0.01 kr.
Litertæller	, kapacitet	999.99 liter
	, deling	0.01 liter
Dagspris	, kapacitet	99.99 kr. pr. liter
	, deling	0.01 kr. pr.liter
Verifikationstolerance		± 5 o/oo

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation	Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed. Efter indgreb i en hydraulik eller en pulsgiver verificeres kun det tilsvarende måleorgan. Efter indgreb i den indvendige elektronikenhed verificeres alle måleorganer.
Påskrifter	Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes "ikke verificeret". Skalaplade: Kroner, Liter og Kroner pr. liter. Verifikationen gælder kun detaillitertælleren. Ved synsglas: Glasset skal være fyldt. Verifikationsskilt: Til benzin, petroleum eller gasolie. Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr., Max. liter pr. min. Verifikationen gælder kun udmåling over liter. Skilt for verifikationsmærkater placeres i nærheden af skala-pladen. Dobbeltstående standere skal have ét sådant skilt på hver side. Det udformes således, at måleorganernes placering og bogstavbetegnelse klart fremgår, og så der er plads til at anbringe verifikationsmærkater for hvert måleorgan.

Plombering

Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med
verifikationsmærke:

Reguleringsskive på måleorgan.

Impulsgiver mod åbning og til standers chassis.

Computerbox mod åbning og til chassis.

Industri- og Handelsstyrelsen forbeholder sig ret til at
kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Multiproduktstanderen er opbygget af et grundmodul type
DP-9000-GM1, sammen med et eller flere pumpemoduler,
type DP 9000-XXXX-X, se "Typer". Det hydrauliske system
er af fabrikat Tatsuno og består af en eller to pumper med
luftudskiller, type PGS-0257-L, hver med et måleorgan type
MP-02515-G, tilsluttet en to-kanal impulsgiver af fabrikat
Scancon, type 2D.

Udleveringen styres med magnetventiler. Ved blend benyt-
tes Gilbarco hydraulisk blendventil.

Det elektriske system er af fabrikat Gilbarco, type EPSILON,
med krone-, liter- og dagsprisvisning på begge sider af stan-
deren. Visningen er elektromekanisk og bibeholdes ved
strømsvigt. Der er mulighed for liter- og kroneforvalg. Ved
dobbelt-sidede stander er det muligt at tanke fra begge sider
af standeren ad gangen. Det er kun muligt at tanke med en
pistol pr. side ad gangen. Aktivering sker ved pistoltagning.
Standeren er forberedt for tilslutning af fjernbetjenings- og
fjernregistreringsudstyr.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1992-4163-0191.

P. Claudi Johansen.